delfi care



varioportoXXL

CE MD

Gebrauchsanweisung
varioporto XXL Duschklappsitz

Artikelnummern:
75059

V02 • 08/2026

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Informationen ... 3
1.1 Allgemeines ... 3
1.2 Konformitätserklärung ... 3
1.3 Zweckbestimmung ... 3
1.4 Indikationen ... 3
1.5 Kontraindikationen ... 3
1.6 Kontaktinformationen ... 4
1.7 Gewährleistung ... 4
1.8 Haftung ... 4
2 Sicherheitshinweise ... 5
3 Produktbeschreibung ... 6
3.1 Lieferumfang ... 6
3.2 Exemplarische Darstellung ... 6
3.3 Technische Daten ... 7
3.3.1 Technische Daten ... 7
3.3.2 Lebensdauer ... 7
3.3.3 Produktkennzeichnung ... 7
4 Produkt in Betrieb nehmen ... 8
4.1 Geeignete Untergründe für die Montage ... 8
4.2 Vorbereitung der Montage ... 8
4.3 Montage ... 9
5 Reinigung, Wartung und Entsorgung ... 12
5.1 Reinigung und Desinfektion ... 12
5.2 Wartung/Wiedereinsatz ... 12
5.3 Entsorgung ... 12
6 Produkt außer Betrieb nehmen ... 13

1 Wichtige Informationen

1.1 Allgemeines

Die Gebrauchsanweisung enthält wichtige Sicherheitshinweise und Beschreibungen für die richtige Montage, Bedienung und Pflege.

Die Gebrauchsanweisung muss dem Benutzer bereitgestellt werden und muss auch bei Weitergabe/Wiedereinsatz des Produkts beim Produkt bleiben.

Die Gebrauchsanweisung muss vor der Inbetriebnahme und Benutzung des Produkts sorgfältig gelesen und vollständig beachtet werden.

Bei Fragen oder Informationsbedarf an den delficare-Fachhändler wenden, der das Produkt geliefert hat.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.

Die aktuelle Version der Gebrauchsanweisung kann als PDF beim Kundenservice der delficare GmbH angefordert werden. Dabei sind vergrößerte Formate zur Darstellung für sehbehinderte Personen möglich. Eine barrierefreie Gebrauchsanweisung ist seitens der delficare GmbH nicht lieferbar.

1.2 Konformitätserklärung

Für das beschriebene Produkt erklärt die delficare GmbH die Konformität gemäß der Verordnung über Medizinprodukte (EU) 2017/745 (MDR).

1.3 Zweckbestimmung

Der wandmontierte Duschklappsitz ist eine nicht-invasive Duschhilfe, die für Personen mit eingeschränkter Standsicherheit, physischen Funktionseinschränkungen oder Gleichgewichtsproblemen konzipiert ist. Das Produkt dient als stabile Sitzhilfe im häuslichen oder klinischen Umfeld, um die selbstständige oder unterstützte Körperpflege in der Dusche zu ermöglichen und das Sturzrisiko zu minimieren.

1.4 Indikationen

Der varioporto XXL Duschklappsitz ist für Personen konzipiert, bei denen folgende Funktionseinschränkungen auftreten:

Standunsicherheit/Stehunfähigkeit bei Gebrauchsminderung oder fehlender Funktionsfähigkeit der unteren Extremitäten oder andere Erkrankungen, die die Standsicherheit beeinträchtigen (z. B. Kraftverlust bei bösartigen Erkrankungen, chronische, fortgeschrittene Herz-/Kreislauf- und Lungenerkrankungen), sodass eine eigenständige Nutzung der Dusche im Sitzen noch ermöglich ist.

1.5 Kontraindikationen

Der varioporto XXL Duschklappsitz ist nur zum Sitzen für Personen mit einem Körpergewicht von max. 250 kg geeignet. Der varioporto XXL Duschklappsitz darf nicht von Personen verwendet werden, die nicht in der Lage sind, ihr Gleichgewicht im Sitzen zu kontrollieren. Der varioporto XXL Duschklappsitz darf nicht als Aufstiegshilfe oder zu ähnlichen Zwecken verwendet werden.

1.6 Kontaktinformationen

Hersteller	delficare GmbH
Anschrift	Weißenbachstrasse 1 88316 Isny/Allgäu
Telefon	+49 (0) 75 62 / 91 25 11
Telefax	+49 (0) 75 62 / 91 25 24
E-Mail	info@delficare.de
Internet	www.delficare.de

1.7 Gewährleistung

Die Laufzeit der Garantie beträgt zwei Jahre. Sie erstreckt sich auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind Schäden, die sich als Folge von übermäßiger Beanspruchung, unsachgemäßer Handhabung, gewaltsamer Beschädigung oder unzulässiger Änderung/Instandsetzung ergeben.

Für Anwendungs- und Montagefehler, sowie Beschaffenheit und Tragfähigkeit der Untergründe übernimmt die delficare GmbH keine Haftung.

Änderungen am Produkt aufgrund technischer Verbesserungen und Designmodifikationen bleiben vorbehalten.

1.8 Haftung

Die delficare GmbH haftet nur, wenn die Produkte unter den vorgegeben Bedingungen und zu den vorgegebenen Zwecken eingesetzt werden. Es wird erwartet, die Produkte sachgemäß zu handhaben und entsprechend der Anleitung zu pflegen.

Generell darf nur Originalzubehör der delficare GmbH verwendet werden. Wenn Fremdprodukte an dem Produkt montiert werden, dann geht die Verantwortung für die Sicherheit des Produktes an denjenigen über, der das Zubehör montiert bzw. den An-/ Umbau vornimmt. Die Konformität der Kombination aus Zubehör oder Anbau und Produkt ist dann neu durch denjenigen, der an- bzw. umbaut, zu erklären. Die von der delficare GmbH nach MDR 2017/745, Anhang II, erklärte Konformität erlischt.

Für die Montage und Demontage übernimmt die delficare GmbH keine Haftung.

2 Sicherheitshinweise

Achtung: Der Kleber für die Wandbefestigung ist für den Nassbereich geeignet, muss aber regelmäßig abtrocknen können. Eine gute Lüftung ist wichtig, insbesondere in fensterlosen Badezimmern und wenn mehrere Personen nacheinander duschen. Zur Lüftung empfiehlt es sich, die Tür des Badezimmers und der Duschkabine offen zu halten.

Nach der Montage und vor jeder Benutzung muss aus sicherem Stand an dem Duschklappsitz gerüttelt werden, um die Klebewirkung zu prüfen. Wenn bei der Prüfung eine nachlassende Klebewirkung festgestellt wird, darf der Duschklappsitz nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall die Firma kontaktieren, die den Duschklappsitz installiert hat.

Bei der Nutzung immer ruhig und gerade in der Mitte der Sitzeinheit sitzen und bei Bedarf eine Betreuungsperson zur Hilfe holen, wenn Unterstützung beim Hinsetzen und Aufstehen nötig ist. Dabei müssen alle Stellfüße müssen sicher auf dem Boden aufstehen. Beim Falten der Sitzeinheit besteht Klemmgefahr für die Hände, deshalb die Sitzplatte nur von vorne anfassen. Es besteht Kipp- und Ausrutschgefahr.

Folgendes beachten:

- Nur der autorisierte Fachhandel darf die Montage aus Sicherheitsgründen durchführen
- Um die Klebeverbindung nicht chemisch anzugreifen und die Haftkraft dauerhaft zu garantieren, keine aggressiven oder stark sauren Reinigungsmittel (z. B. starke Kalkreiniger, Sanitärgrundreiniger oder säurehaltige Reiniger) bei der Reinigung verwenden
- Für die Sicherheit des Benutzers den Artikel nur wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwenden (nicht missbräuchlich) und die maximale Belastung von 250 kg nicht überschreiten
- Bei Montagefehlern (z. B. unzureichende Reinigung) oder der Montage auf ungeeigneten Untergründen (z. B. nanobeschichtete Oberflächen) kann die anfänglich optimale Klebewirkung mit der Zeit nachlassen. Daher müssen Benutzer die Klebekraft vor jeder Anwendung prüfen. Bei der Prüfung ist darauf zu achten, dass die beiden Sternschrauben fest angezogen sind. Wenn sich bei dieser Prüfung herausstellt, dass die Klebewirkung nachgelassen hat, darf das Produkt nicht mehr benutzt werden. In diesem Fall an die Firma wenden, die das Produkt installiert hat
- Bei jedem schwerwiegenden Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, kontaktiert werden. In Deutschland ist es das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Berlin: www.bfarm.de

3 Produktbeschreibung

Der varioporto XXL Duschklappsitz ist ein Medizinprodukt der Klasse 1 gem. MDR Anhang VIII.

3.1 Lieferumfang

- 1 x Sitzeinheit
- 4 x Stellfuß (montiert)
- 1 x Reinigungsset (Schleifschwamm, Sanitärscheuermilch, delfi-clean Haftreiniger, Vliestücher)
- 1 x Klebekit (Klebetuben, Dichtmasse, Schlüssel SW13)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Hinweis: Den Kleber innerhalb eines Jahres ab Auslieferdatum verwenden, um eine ordnungsgemäße Klebewirkung zu gewährleisten (siehe MHD am Tubenfalz).

3.2 Exemplarische Darstellung

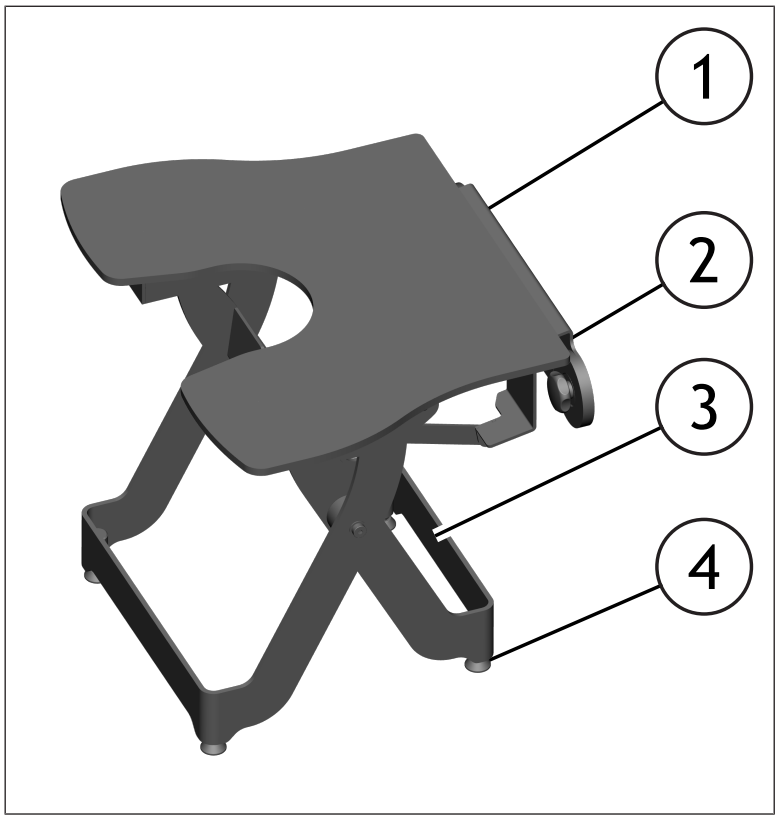


Abb. 1: varioporto xxl Duschklappsitz (exemplarisch)

1	Duschklappsitz	2	Sterngriffschraube und Klebeadapter
3	Stützfuß	4	Stellfuß

3.3 Technische Daten

3.3.1 Technische Daten

Bezeichnung	Wert
Breite	60 cm
Tiefe	48 cm
Sitztiefe	43 cm
Sitzhöhe	50 cm
Gewicht	9,5 kg
Max. Belastung	250 kg
Temperatur der Oberfläche/ Verarbeitungstemperatur	15 °C — 25 °C
Lebensdauer	10 Jahre
Material	Aluminium, Kunststoff
Artikelnummer	75059
Bezeichnung	varioporto XXL Duschklappsitz

Tab. 1: Technische Daten

3.3.2 Lebensdauer

Die ISO 17966 § 16.3 legt für den Homecare-Bereich eine zweimalige Benutzung pro Tag fest. Auf dieser Grundlage wurde der varioporto XXL Duschklappsitz auf eine Lebensdauer von 10 Jahren getestet.

3.3.3 Produktkennzeichnung

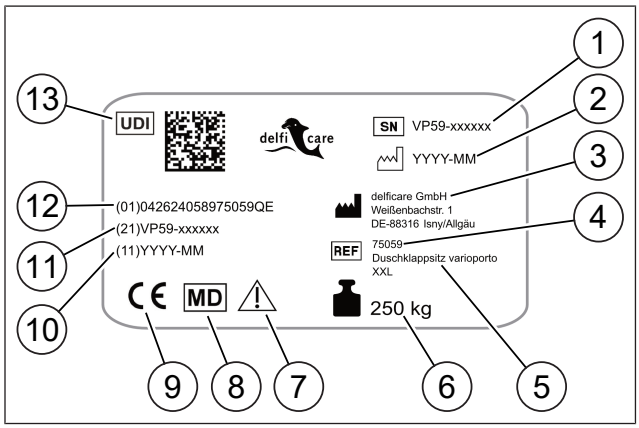


Abb. 2: Typenschild (exemplarisch)

1	Seriennummer	2	Produktionsdatum (Jahr-Monat)
3	Hersteller	4	Artikelnummer
5	Artikelbezeichnung	6	Max. Belastung
7	Informationsbeilage beachten	8	Medizinprodukt
9	CE-Zertifizierung	10	Produktionsdatum (Jahr-Monat)
11	Seriennummer	12	Device Identifier
13	UDI-Code		

4 Produkt in Betrieb nehmen

4.1 Geeignete Untergründe für die Montage

Geeignete Untergründe

Für eine optimale Haftung kann es je nach Untergrund notwendig sein, die Oberfläche mechanisch anzurauhen oder einen Primer/Haftmittler zu verwenden.

Für den varioporto XXL Duschklappsitz sind die folgenden soliden, planen (kein Fliesenversatz) und tragfähigen Untergründe geeignet:

- Glatte oder raue Fliesen
- Steine
- Glas
- Beton
- Metall
- Holz



Holz | Fliesen | Glas | Granit | Marmor | Stein

Ungeeignete Untergründe


Für den varioporto XXL Duschklappsitz sind folgende Untergründe nicht geeignet:

- Loser Putz
- Tapeten
- Textile Untergründe
- Kunststoffe (z. B. PE, PP, PTEE)
- Plexiglas
- Polycarbonat

4.2 Vorbereitung der Montage


Der folgende QR-Code führt zu einem Video, das als zusätzliche Quelle für die Gebrauchsanweisung zur Prüfung des Untergrunds und zur Vorbereitung der Montage dient:

Untergrund auf Hohlklang prüfen




1. Den Untergrund durch Abklopfen mit dem Finger auf Hohlklang prüfen.
Bei Hohlklang Schritt 3 beachten.

Untergrund auf Fliesenversatz prüfen



2. Den Untergrund mit der Wasserwaage auf Fliesenversatz prüfen. Dazu mit einer Cent-Münze prüfen, ob sich die Cent-Münze in den entstandenen Spalt einführen lässt. Lässt sich die Cent-Münze einführen, ist der Fliesenversatz zu groß.
Bei Fliesenversatz Schritt 3 beachten.

Befestigung mit Dübeln und Schrauben bei ungeeignetem Untergrund



3. Bei Hohlklang und zu großem Fliesenversatz: Den Haltegriff mit Dübel und Schrauben befestigen. Dabei den Bohradapter von der delficare GmbH gemäß der beiliegenden Montageanleitung verwenden.

Luftfeuchtigkeit prüfen



4. Die Luftfeuchtigkeit im Bad prüfen. Wenn zuvor eine Person geduscht hat oder sich ein Feuchtigkeitsfilm auf den Fliesen befindet, den Raum lüften, bis die Fliesen trocken sind.


Temperatur prüfen




5. Die Temperatur der zu beklebenden Oberfläche prüfen, um eine optimale Verarbeitungstemperatur zwischen 15 °C —30 °C zu gewährleisten. Bei Bedarf die beklebende Oberfläche mit einem Föhn erwärmen.
⇨ Die Vorbereitung der Montage ist abgeschlossen.

4.3 Montage


Fliesen reinigen und Duschklappsitz vorbereiten





1. Den Duschklappsitz ausklappen und an die gewünschte Stelle positionieren. Dabei darauf achten, dass der Duschklappsitz waagerecht steht und stabil auf dem Duschwannenboden aufliegt. Der Duschklappsitz varioporto XXL ist für Duschwannen mit Rändern bis maximal 5 cm x 5 cm geeignet.




2. Wenn der Duschklappsitz nicht waagerecht steht und nicht stabil auf dem Duschwannenboden aufliegt, die Muttern der Stellfüße (Schlüsselweite 13) lösen und die Stellfüße auf die notwendige Höhe herausdrehen, bis die Sitzfläche waagerecht ist und die Stellfüße dem Gefälle der Duschwanne angepasst sind. Anschließend die Muttern wieder festziehen.




3. Die vorgesehenen Klebestellen des Duschklappsitzes mit dem Schleifschwamm und der Sanitärscheuermilch reinigen, damit die Klebestellen fett- und schmutzfrei sind.



	4. Die vorgesehenen Klebestellen mit dem mitgelieferten Vliestuch reinigen, um alle Rückstände der Sanitärscheuermilch zu entfernen.
	5. Den delfi-clean Haftreiniger großzügig auf die vorgesehenen Klebestellen aufsprühen und sofort mit einem frischen Tuch abwischen. Diesen Vorgang mindestens zweimal wiederholen, um alle Rückstände zu entfernen. Bei älteren Fliesen den Vorgang drei- oder viermal wiederholen, sodass alle Rückstände entfernt sind.

Duschklappsitz befestigen


	6. Die Schutzfolien der Klebeadapter entfernen.
	7. Den Duschklappsitz an den gereinigten Klebstellen fest an die Wand drücken.

Schrauben herausdrehen und Klebstoff einfüllen



	8. Die beiden Sterngriffschrauben lösen. Anschließend die Sitzeinheit von der Wand nehmen und die Klebeadapter fest an die Wand drücken. Falls die runden Klebeadapter auf einer Fliesenfuge liegen: Die Fliesenfuge mit der beigelegten Dichtmasse schließen, um den Austritt des Klebstoffs zu verhindern.
	9. Mit dem mitgelieferten roten Schlüssel die Spitze der Klebetube aufstechen.
	10. Das Ende der Klebetube um eine Falz entfalten, den roten Schlüssel einfädeln und um eine Falz aufrollen.

	11. Die Spitze der Klebetube fest und dicht in die große Öffnung durch eine Drehbewegung in den Klebeadapter stecken.
	12. Das Ende der Klebetube mit dem roten Schlüssel langsam aufrollen, damit der Klebstoff gleichmäßig in den Klebeadapter fließt.
	13. Das Aufrollen des Klebstoffs beenden, sobald der Klebstoff an der kleinen Öffnung austritt. **Den Klebeadapter nicht an die Wand drücken, sodass keine Hohlräume zwischen der Wand und dem Klebeadapter entstehen.**

Duschklappsitz fixieren

	14. Den Duschklappsitz auf die Klebeadapter positionieren und die Sterngriffschrauben **ohne Andrücken** eindrehen.

Kleber aushärten lassen und prüfen

	15. Den Klebstoff aushärten lassen. Dabei 24 Stunden lang den Kleber vor Feuchtigkeit schützen und den Duschklappsitz nicht belasten. In den ersten 12 Stunden den Duschklappsitz nicht hochklappen, da er waagerecht abgestützt bleiben muss.
	16. Nachdem der Klebstoff ausgehärtet ist, lässt sich der Duschklappsitz zusammen- oder ausfalten. Zum Zusammenfalten: Die Sitzeinheit hochziehen. Die Fußstütze klappt sich dabei selbstständig ein. Zum Auseinanderfalten: Die Sitzeinheit nach vorne ziehen. die Fußstütze klappt sich dabei selbstständig aus.
	⇨ Der Duschklappsitz ist montiert.

5 Reinigung, Wartung und Entsorgung

5.1 Reinigung und Desinfektion

Reinigung

Der varioporto XXL Duschklappsitz kann 24 Stunden nach der Montage mit haushaltsüblichen Reinigungsmitteln (z. B. ein Mikrofasertuch mit wenigen Tropfen Spülmittel) gereinigt werden. Für die Reinigung keine aggressiven oder stark sauren Reinigungsmittel (z. B. starke Kalkreiniger, Sanitärgrundreiniger oder säurehaltige Reiniger), um die Klebeverbindung nicht chemisch anzugreifen und die Haftkraft dauerhaft zu garantieren.

Desinfektion

Der varioporto XXL Duschklappsitz lässt sich mit haushaltsüblichen Desinfektionsmitteln (Wisch- oder Sprühdesinfektion) reinigen.

5.2 Wartung/Wiedereinsatz

Der Duschklappsitz ist wartungsfrei.

Bei einer notwendigen Instandsetzung den Duschklappsitz an den Fachhandel übergeben und den Duschklappsitz nicht weiter verwenden.

Ein Wiedereinsatz ist nicht erlaubt.


5.3 Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweiligen nationalen gesetzlichen Bestimmungen erfolgen. Dabei müssen die Geräteverpackung und die Kunststoffteile der Wertstoffwiederverwertung zugeführt werden.

Nähere Informationen zu örtlichen Entsorgungsunternehmen können bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung eingeholt werden.


6 Produkt außer Betrieb nehmen

Produkt von der Wand lösen




1. Die Sterngriffschrauben und die kleinen Schrauben lösen und die Sitzeinheit von der Wand abnehmen.

Klebeadapter entfernen



2. Mit einer Spachtel und einem Hammer an die Klebeadapter ansetzen, vorsichtig ringsherum klopfen und von der Wand lösen.

Klebereste entfernen



3. Die Klebereste mit einem Glasschaber entfernen. Bei rauen Oberflächen oder Fugen einen Silikonentferner oder Aceton verwenden.

⇨ Der Klebeadapter und die Klebereste sind entfernt.

delfi care

Kleben statt Bohren

V02 • 08/2026